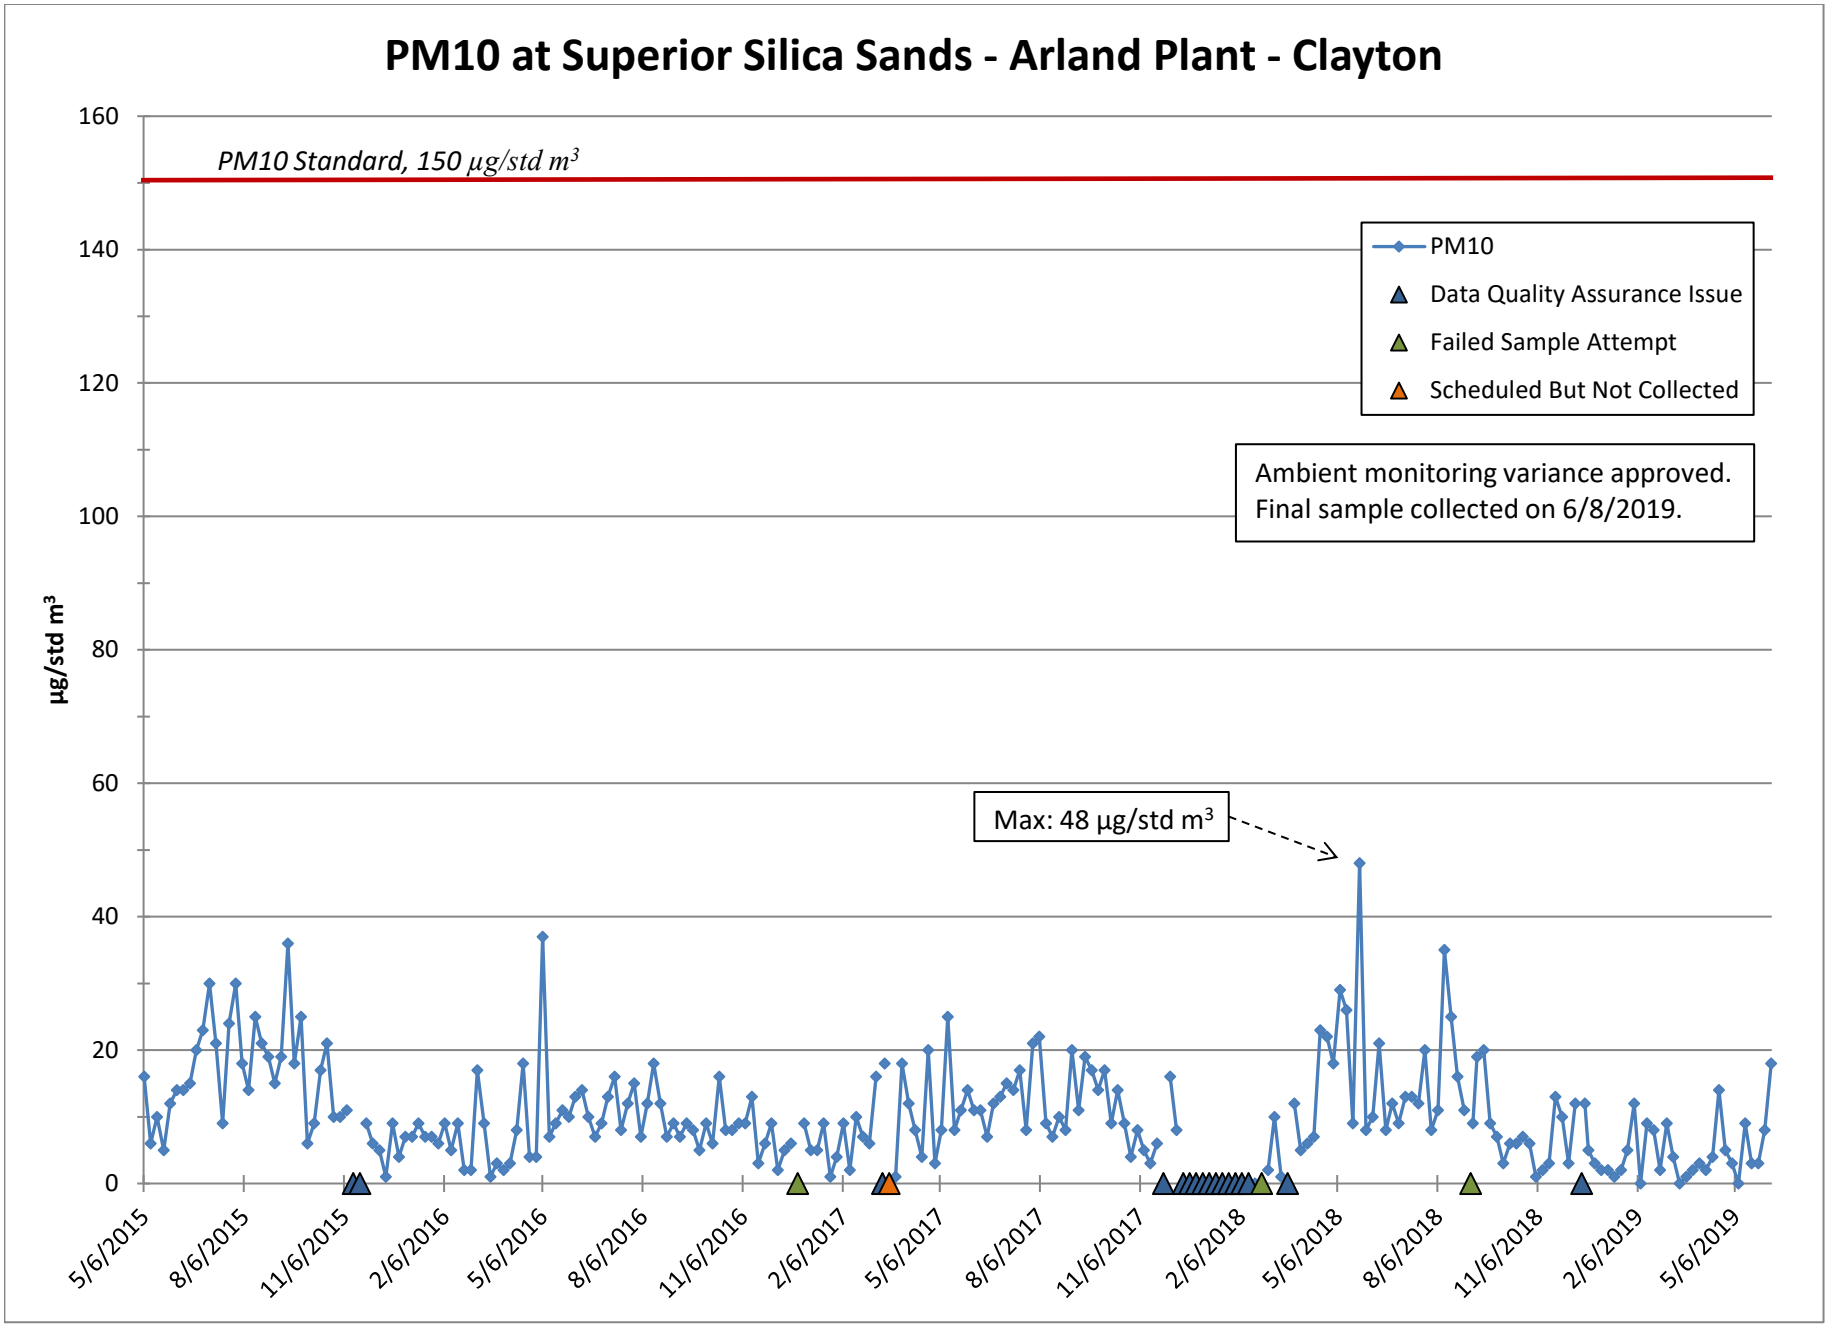
PM10 at Superior Silica Sands - Arland Plant - Clayton
PM10 Standard, 150 µg/std m³
PM10
Data Quality Assurance Issue
Failed Sample Attempt
Scheduled But Not Collected
Ambient monitoring variance approved.
Final sample collected on 6/8/2019.
Max: 48 µg/std m³
µg/std m³
160
140
120
100
80
60
40
20
0
5/6/2015
8/6/2015
11/6/2015
2/6/2016
5/6/2016
8/6/2016
11/6/2016
2/6/2017
5/6/2017
8/6/2017
11/6/2017
2/6/2018
5/6/2018
8/6/2018
11/6/2018
2/6/2019
5/6/2019